Aoralscan Elite

Guide de Nettoyage, Désinfection et Stérilisation

1. ÉTAPES DE NETTOYAGE (Systématiques avant traitement)

1. **Déconnexion :** Débranchez l'alimentation et retirez l'embout du corps du scanner.
2. **Pré-nettoyage :** Rincez à l'eau distillée pendant **3 min** (élimine salive et sang).
3. **Brossage :** Utilisez un surfactant enzymatique pendant **3 min** (répétez 2 fois).
    - *Intérieur :* Insérez la brosse éponge par les deux extrémités, nettoyez en petits cercles.
    - *Extérieur :* Brossez délicatement d'avant en arrière.
4. **Rinçage :** Rincez soigneusement à l'eau distillée pendant au moins **3 min**.
5. **Vérification :** Si une tache ou empreinte persiste sur la lentille, répétez les étapes 3 et 4.
6. **Séchage :** Essuyez avec un chiffon doux non pelucheux. Laissez sécher dans un endroit ventilé ou utilisez un sèche-linge pendant **10 minutes**.
7. **Inspection :** Assurez-vous que l'objectif est propre et sans dommages.

---

2. OPTION A : Stérilisation Autoclave (Haute Température)

1. **Préparation :** Remplissez l'embout de gaze médicale et scellez-le dans un sac d'autoclave (voir Figure 4).
2. **Paramètres de stérilisation :**
    - **121°C** pendant **30 min** (pression : 102,9 kPa).
    - **OU 134°C** pendant **4 min** (pression : 205,8 kPa).
3. **Séchage & Refroidissement :** Séchez pendant **30 min**. Laissez refroidir à température ambiante pour éviter les brûlures.
4. **Finalisation :** Inspectez la lentille. Reconnectez immédiatement ou stockez au sec.

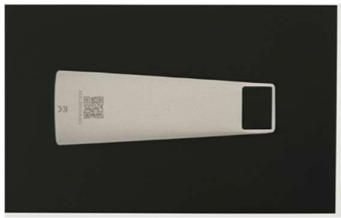

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

---

3. OPTION B : Désinfection de Haut Niveau

1. **Immersion :** Remplissez un bac de **(5,5 g/L)**. Immergez l'embout pendant **12 min**.
2. **Rinçage des résidus :** Rincez à l'eau distillée **3 fois** (1 minute à chaque fois).
3. **Rinçage final :** Rincez à nouveau à l'eau distillée pendant **3 min**.
4. **Séchage :** Chiffon doux non pelucheux, puis séchage à l'air libre ou sèche-linge pendant **30 min**.
5. **Inspection :** Vérifiez que la lentille est propre et intacte.
6. **Stockage :** Reconnectez le scanner ou rangez l'embout dans un milieu sec.

Note réglementaire : Le processus de nettoyage et de désinfection est conforme au Règlement sur la Technique de Désinfection et de Stérilisation des Instruments Dentaires WS 506-2016. Pour plus de détails, veuillez-vous référer au manuel d'utilisation.